



Balança de elevação

MANUAL DO USUÁRIO **MHS2500I**



Mantenha o manual de instruções à mão e siga as instruções de uso.

ÍNDICE

I. Explicação dos Símbolos Gráficos na Etiqueta/Embalagem	4
II. Aviso de Direitos Autorais	6
III. Notas de Segurança	7
A. Informações Gerais	7
B. Orientação EMC e Declaração do Fabricante	10
IV. Instalação.....	14
A. Aviso de segurança	14
B. Inserindo pilhas	20
V. Indicador e funções de tecla	21
A. Indicador de dispositivo (modelo OIML)	21
VI. Usando o dispositivo	24
A. Operação básica	24
B. Hold	24
C. BMI (modelo de 3 chaves)	25
D. Tare	25
VII. Configuração do dispositivo	27
VIII. Solução de problemas.....	30
Auto-inspeção	31
É necessário suporte do distribuidor	32
Mensagens de erro.....	33
IX. Especificações do produto	34
A. Informações do dispositivo.....	34
X. Declaração de Conformidade.....	35

I. Explicação dos Símbolos Gráficos na Etiqueta/Embalagem

Texto/Símbolo	Significado
	Atenção, consulte os documentos acompanhantes antes de usar
	Coleta separada para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, em conformidade com a Diretiva 2002/96/CE. Não descarte o dispositivo com o lixo comum
	Nome e endereço do fabricante do dispositivo, e ano/país de fabricação
	Leia cuidadosamente o manual do usuário antes da instalação e do uso, e siga as instruções de uso
	Dispositivo médico elétrico, Parte aplicada Tipo B
	Dispositivo médico elétrico, Parte aplicada Tipo BF
	Número de catálogo do dispositivo / número do modelo
	Nome e endereço do representante autorizado na União Europeia
	O dispositivo é um dispositivo médico. O texto indica o tipo de categoria do dispositivo
	Número do lote ou série do fabricante do dispositivo
	Número de série do dispositivo
	Identificador Único do Dispositivo
e	Intervalo da Escala de Verificação. Valor expresso em unidades de massa. Usado para classificação e verificação de um instrumento.
	O dispositivo está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 sobre Dispositivos Médicos. Número de quatro dígitos é o identificador para o Organismo Notificado de Dispositivo Médico

O dispositivo está em conformidade com as diretivas CE (apenas modelos verificados)

CE **M20** 0122

M: Etiqueta de conformidade em conformidade com a Diretiva 2014/31/UE para instrumentos de pesagem não automáticos
20: Ano em que a verificação de conformidade foi realizada e a etiqueta CE foi aplicada. (ex: 16=2016).
0122: Identificador para o Organismo Notificado de Metrologia



O dispositivo é uma balança de Classe III em conformidade com a Diretiva 2014/31/UE (apenas modelos verificados)



Nome e endereço da entidade que importa o dispositivo (se aplicável)



Nome e endereço da entidade responsável pela tradução das Informações de Uso (se aplicável)

CON.

Contador de eventos confirmando quantas vezes o dispositivo foi calibrado (se aplicável)



O dispositivo está em conformidade com a aprovação da Comissão Nacional de Comunicações de Taiwan (NCC)



O dispositivo está em conformidade com os regulamentos da Comissão Federal de Comunicações dos EUA

UK **CA** **M 20** 8506

O dispositivo está em conformidade com os regulamentos de instrumentos de pesagem não automáticos do Reino Unido de 2016 (apenas modelos verificados)

M: Etiqueta de conformidade em conformidade com os Regulamentos de Instrumentos de Pesagem Não Automáticos de 2016

20: Ano em que a verificação de conformidade foi realizada e a etiqueta UKCA foi aplicada. (ex: 20=2020)

8506: Identificador do organismo de metrologia aprovado



O dispositivo está em conformidade com toda a legislação aplicável do Reino Unido



Polaridade da energia do dispositivo

"Em caso de divergências, o ícone no próprio dispositivo tem precedência."

II. Aviso de Direitos Autorais

Aviso de Direitos Autorais Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan

Tel: +886-4-2406 3766

Fax: +886-4-2406 5612

Website: www.chardermedical.com

E-mail: info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. Todos os direitos reservadosd.

Este manual do usuário é protegido pela lei internacional de direitos autorais. Todo o conteúdo é licenciado, e o uso está sujeito a autorização por escrito da Charder Electronic Co., Ltd. (doravante Charder). A Charder não se responsabiliza por danos causados pelo não cumprimento das exigências indicadas neste manual.

A Charder reserva-se o direito de corrigir erros de impressão no manual sem aviso prévio e modificar o exterior do dispositivo para fins de qualidade sem o consentimento do cliente.



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

III. Notas de Segurança

A. Informações Gerais

Obrigado por escolher este dispositivo médico da Charder. Ele foi projetado para ser fácil e simples de operar, mas, se você encontrar quaisquer problemas que não sejam abordados neste manual, entre em contato com o parceiro de serviço local da Charder.

Antes de iniciar a operação do dispositivo, leia cuidadosamente este manual do usuário e mantenha-o em um local seguro para referência futura. Ele contém instruções importantes sobre instalação, uso adequado e manutenção.

Finalidade Prevista

Este dispositivo médico foi projetado para ser utilizado de acordo com as regulamentações nacionais, para medir peso dentro das especificações, em aplicações relacionadas ao peso por profissionais.

O paciente senta-se em uma tipoia acoplada ao dispositivo, que está conectado a um sistema de elevação. O sistema de elevação suspende o paciente do chão enquanto o dispositivo mede o peso.

Benefício Clínico

Os resultados das medições podem ser utilizados por profissionais para diagnosticar (e monitorar) problemas relacionados ao peso.

Indicações/Contraindicações Médicas Previstas

Medição: peso corporal do paciente.

Contraindicações conhecidas: não há contraindicações conhecidas para a medição do peso corporal.

Perfil Previsto do Paciente

- (a) Idade: sem restrições
- (b) Peso: sem restrições, dentro da capacidade de peso do dispositivo (nota: o dispositivo é usado em conjunto com um sistema de elevação; assim, a capacidade máxima do sistema de elevação também deve ser considerada. Se for inferior à capacidade do dispositivo, a menor capacidade deve ser usada como limite superior).
- (c) Condições do Paciente: necessitam de medição do peso corporal. Provavelmente estarão sentados em uma tipoia conectada ao

sistema de elevação.

Perfil Previsto do Usuário

- (a) Idade: pelo menos 20 anos
- (b) Conhecimento Mínimo:
 - Capaz de ler em nível de ensino médio e compreender números arábicos (por exemplo, 1, 2, 3, 4...)
 - Conhecimento básico de higiene
 - Treinamento na operação do dispositivo
 - Leitura do manual de instruções
- (c) Idioma
 - Capaz de ler o idioma do manual de instruções e as instruções exibidas na tela
- (d) Qualificações
 - Nenhuma certificação ou qualificação especial necessária
 - Capaz de ajudar a apoiar o paciente durante o processo de elevação

Avaliação de Risco Residual

- (a) Todos os riscos previsíveis foram avaliados e considerados aceitáveis. De modo geral, o risco mais provável causado pelo uso incorreto do dispositivo é a medição menos precisa (ou a impossibilidade de obter a medição), o que não representa risco físico iminente para o paciente ou o usuário.
- (b) A relação benefício-risco é considerada aceitável. As balanças de elevação são uma opção importante para medir pacientes. O uso do dispositivo é improvável de causar danos ao usuário ou ao paciente.

Manuseio Geral

- Certifique-se de que todas as partes estejam devidamente travadas e apertadas antes de operar o dispositivo.
- A precisão da medição exige que os pés, as costas e a cabeça do sujeito estejam alinhados de forma reta. Observe que a altura pode variar ao longo do dia.
- **CUIDADO:** Não utilize o dispositivo próximo a equipamentos que possam causar interferência eletromagnética ou de outros tipos.

Instruções de Segurança

Antes de colocar o dispositivo em uso, leia atentamente este manual do usuário. Ele contém instruções importantes para a instalação, uso e manutenção do dispositivo.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados pelo não cumprimento das seguintes instruções:

- O dispositivo tem uma vida útil esperada de 5 anos quando manuseado corretamente, mantido e inspecionado periodicamente de acordo com as instruções do fabricante.
- A instalação inadequada tornará a garantia nula e sem efeito.
- Observe as temperaturas ambiente permissíveis para o uso.

Limpeza

A superfície do dispositivo deve ser limpa utilizando lenços umedecidos com base alcoólica.

Manutenção

- Entre em contato com o distribuidor local da Charder para manutenção regular e calibração. A verificação periódica da precisão é recomendada; a frequência deve ser determinada pelo nível de uso e pelo estado do dispositivo.

Garantia/Responsabilidade

- O período de garantia será de dezoito (18) meses, a partir da data de compra. Por favor, guarde o recibo como comprovante de compra.
- Não será aceita responsabilidade por danos causados por qualquer um dos seguintes motivos: armazenamento ou uso inadequado, instalação incorreta ou comissionamento pelo proprietário ou terceiros, desgaste natural, alterações ou modificações, manuseio incorreto ou negligente, interferência química, eletroquímica ou elétrica, a menos que o dano seja atribuído à negligência por parte da Charder.
- Este dispositivo não contém peças de manutenção pelo usuário. Toda manutenção, inspeções técnicas e reparos devem ser realizados por um parceiro de serviço autorizado da Charder, utilizando acessórios e peças de reposição originais da Charder. A Charder não se responsabiliza por danos decorrentes de manutenção ou uso inadequados. A desmontagem do dispositivo anulará a garantia.

Relatório de Incidentes

- Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser reportado ao fabricante, ao representante da UE (se o dispositivo for utilizado em um estado membro da UE) e à autoridade competente do estado membro do usuário/sujeito.

B. Orientação EMC e Declaração do Fabricante

Orientações e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas		
O produto destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do produto deve assegurar que ele seja utilizado nesse ambiente.		
Teste de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético - orientações
RF emissions CISPR 11	Group 1	O produto utiliza energia de RF apenas para sua função interna. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e não são propensas a causar interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
RF emissions CISPR 11	Class A	O produto é adequado para uso em todos os estabelecimentos que não sejam domésticos e aqueles diretamente conectados a uma rede de alimentação de baixa tensão que fornece energia a edifícios usados para fins domésticos.

Orientações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética			
O produto destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do produto deve assegurar que ele seja utilizado em tal ambiente.			
Teste de emissões	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético orientações
Electrostatic discharge(ESD) IEC 61000-4-2	<u>±8 kV contact</u> <u>±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air</u>	<u>±8 kV contact</u> <u>±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air</u>	Os pisos devem ser de madeira, concreto ou ladrilhos cerâmicos. Se os pisos estiverem cobertos com material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%
Power frequency (50, 60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	<u>30 A/m</u>	30 A/m	Os pisos devem ser de madeira, concreto ou ladrilhos cerâmicos. Se os pisos estiverem cobertos com material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%.
NOTE UT é a tensão de alimentação CA antes da aplicação do nível de teste.			

Orientações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética			
O produto destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do produto deve assegurar que ele seja utilizado em tal ambiente.			
Teste de emissões	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - orientações
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80MHz to 2,7 GHz	3 V/m 80MHz to 2,7 GHz	Distância de separação recomendada: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80MHz to 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800MHz to 2,7GHz W Onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts(W) de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). As intensidades de campo de transmissores RF fixos, conforme determinado por uma pesquisa de site eletromagnético^a devem ser menores que o nível de conformidade em cada faixa de frequência^b Pode ocorrer interferência nas proximidades de equipamentos marcados com o seguinte símbolo: 
NOTA1 Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta. NOTA2 Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			
a As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações-base de telefones (celulares/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissões de rádio AM e FM e transmissões de TV, não podem ser previstas teoricamente. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores RF fixos, deve ser considerada uma pesquisa de site eletromagnético. Se a intensidade de campo medida no local onde o produto é utilizado exceder o nível de conformidade RF aplicável acima, o produto deve ser observado para verificar o funcionamento normal. Se for observada uma performance anormal, medidas adicionais podem ser necessárias, como reorientar ou realocar o produto. b Na faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.			


Distância de separação recomendada entre equipamentos portáteis e móveis de comunicações RF e o produto			
O produto foi projetado para uso em um ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF irradiadas são controladas. O cliente ou o usuário do produto pode ajudar a prevenir interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre equipamentos portáteis e móveis de comunicações RF (transmissores) e o produto, conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.			
Potência máxima nominal de saída do transmissor W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz to 2,7 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
Para transmissores com potência máxima nominal não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima nominal do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. NOTA1 Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais alta. NOTA2 Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			

IV. Instalação

A. Aviso de segurança


A balança de elevação NÃO deve inclinar em nenhum momento

1. A balança de elevação NÃO deve inclinar quando instalada no sistema de elevação do paciente.

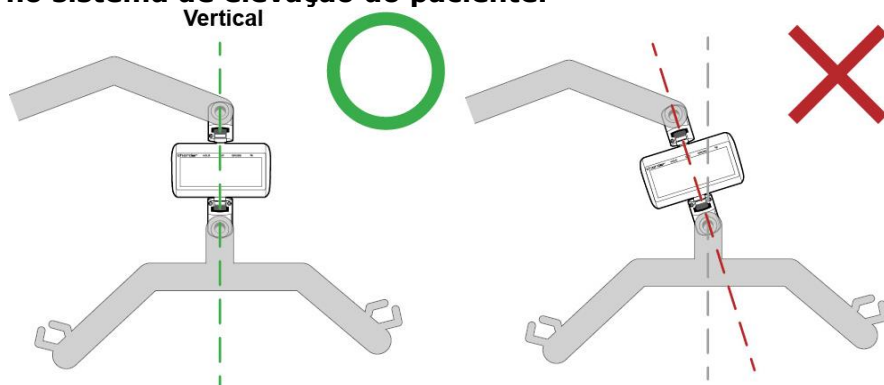

Se a Lift Scale estiver inclinada e não completamente vertical quando instalada, isso fará com que as juntas da Lift Scale dobrem. Isso acabará causando quebra quando usada vezes suficientes e submetida a peso suficiente, porque a força está sendo aplicada contra as juntas de uma forma que elas não foram projetadas para suportar.

2. A balança NÃO deve inclinar em nenhum momento durante a operação do sistema de elevação de pacientes.

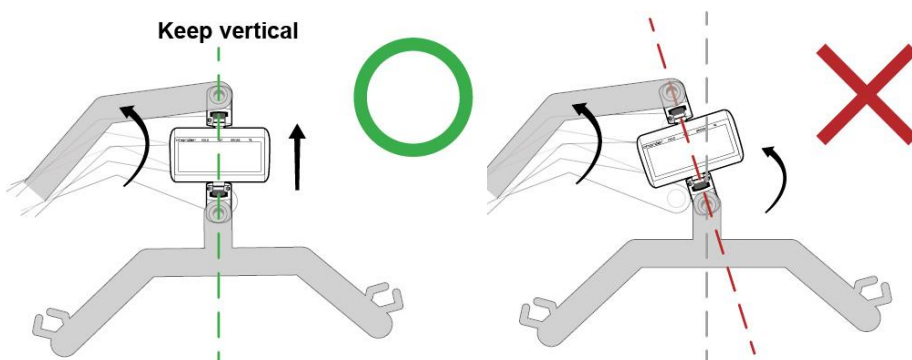


Mesmo que a balança de elevação esteja completamente vertical quando instalada, se ela for dobrada em qualquer ponto da operação (ex.: o sistema de elevação do paciente eleva o paciente para ponto mais alto para medição de peso), o mesmo risco de quebra se aplica.


IMPORTANTE: Se for observada inclinação ou flexão a qualquer momento, a balança de elevação NÃO deve ser usada.

1. Inspeção visualmente as juntas cardan que conectam a balança de elevação ao sistema de elevação do paciente antes do uso.

A balança de elevação foi projetada para ser instalada entre a barra de elevação e o suporte do sistema de elevação do paciente, em uma posição completamente vertical.

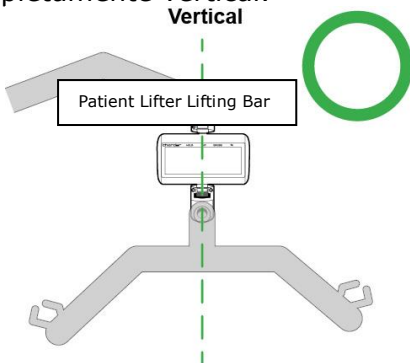

As juntas cardan superior e inferior devem ser inspecionadas quanto a dobras.

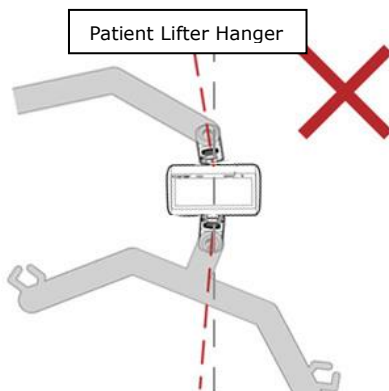

Se algum dano visual ou entortamento for observado, NÃO use a Lift Scale.

2. Se nenhum dano visual for observado, a balança de elevação deve ser girada manualmente para testar se há possibilidade de movimento incorreto.

Charder Lift devem ser instaladas em sistemas de elevação de pacientes utilizando rolamentos giratórios de 360 graus. A rotação deve ser conduzida usando o **Lift System** , em vez do dispositivo.

As juntas cardan nas balanças de elevação MHS2500I / MHS2600I (com juntas cardan **fixas**) NÃO giram. Se puderem ser torcidas manualmente, isso significa que as juntas estão danificadas e a balança de elevação NÃO deve ser usada.



(Modelo de junta cardan não rotativa MHS2500I / MHS2600I)

As juntas cardan nas balanças de elevação MHS2510I / MHS2610I (com juntas cardan **giratórias**) irão girar, mas apenas **horizontalmente** . Se elas puderem ser torcidas manualmente em qualquer outra direção, isso significa que as juntas estão danificadas, e a balança de elevação NÃO deve ser usada.

3. A balança de elevação e a barra de suporte devem ter livre movimento em todas as direções.

Se a Balança de Elevação estiver obstruída de seu movimento livre, uma força de torção será aplicada à Balança de Elevação, causando danos potenciais.

A balança de elevação deve ser instalada no sistema de elevação do paciente que permite rotação livre de 360 graus

1. A rotação deve ser realizada pelo Sistema de Elevação do Paciente com giro livre de 360 graus.




Mesmo se forem utilizadas as balanças elevatórias MHS2510I / MHS 2 610I com juntas cardan rotativas horizontais, a rotação deve ser realizada pelo sistema de elevação do paciente, e não pela balança elevatória, para minimizar o risco de danos à balança elevatória.

Nylock devem ser apertados firmemente de acordo com as especificações


Nylock devem ser fixados de acordo com o procedimento de montagem correto. Prepare uma chave de fenda hexagonal e uma chave de torque.

- 1. Segure/fixe um lado usando uma chave de fenda**
- 2. Aperte/fixe os parafusos Nylock usando a chave de torque (repita do outro lado)**

IMPORTANTE: A força de torque deve ser definida em 18 kgf-cm $\pm$ 1 kgf-cm

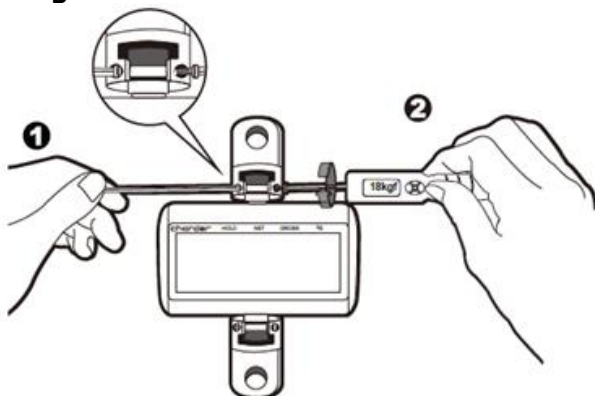


IMPORTANTE: O parafuso Nylock deve ser fixado de ambos os lados (um lado com chave de fenda, o outro lado com chave de torque). O parafuso Nylock não apertará e simplesmente girará no lugar se a contraforça do outro lado não for aplicada.

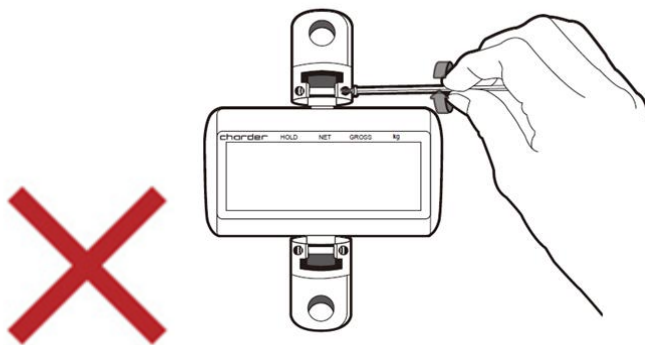

Verifique se todos os parafusos estão totalmente apertados


No.	Item	Qty
A .	Parafuso hexagonal Nylock	2 parafusos por junta
B .	Parafuso de fechamento	1 parafuso por junta

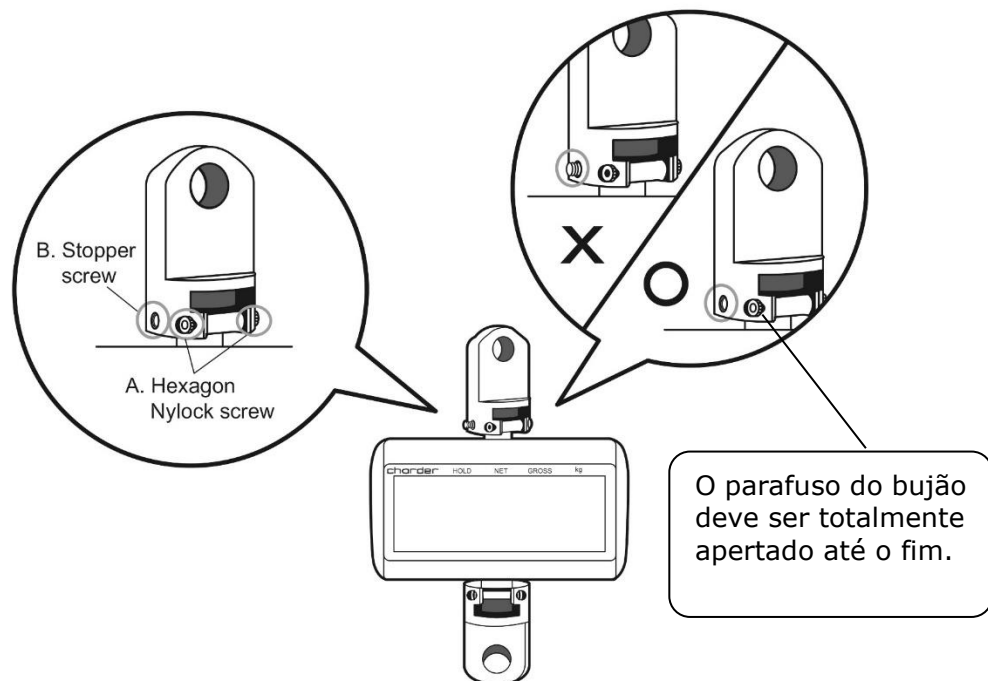


CUIDADO : NÃO use a balança de elevação se algum parafuso estiver solto.

B. Inserindo pilhas


1. Localize a tampa da bateria na parte traseira do dispositivo

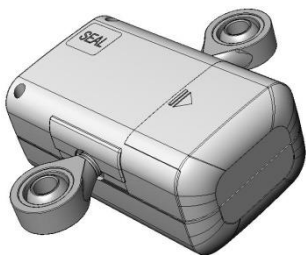


2. Remova a tampa da bateria

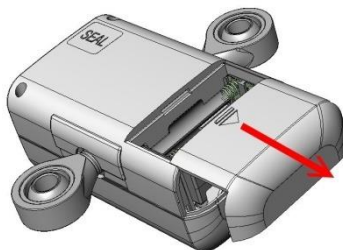


3. Remova a caixa da bateria

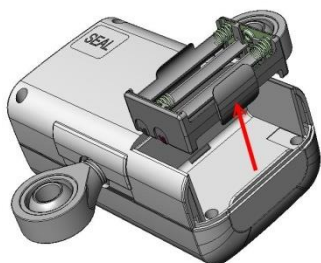


4. Insira as pilhas

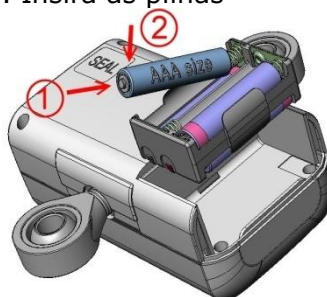

5. Insira a caixa da bateria

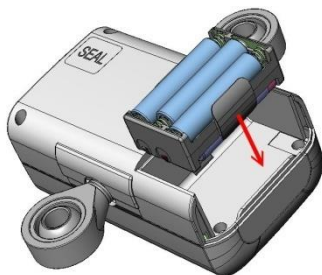


6. Recoloque a tampa da bateria

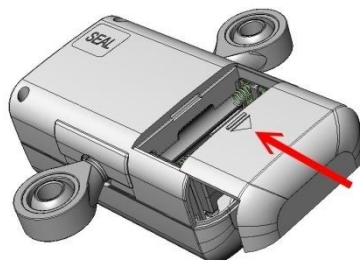


V. Indicador e funções de tecla

A. Indicador de dispositivo (modelo OIML)

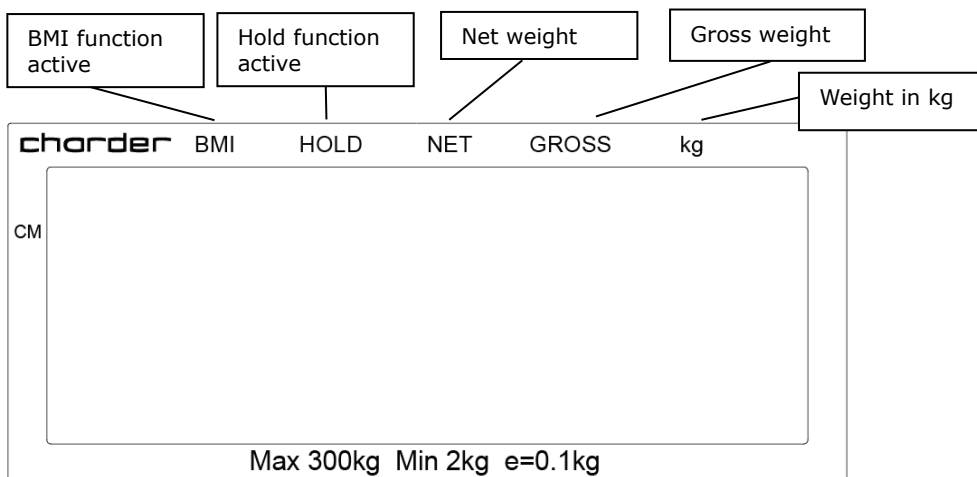


Indicador do dispositivo (modelo de unidade de 3 teclas)

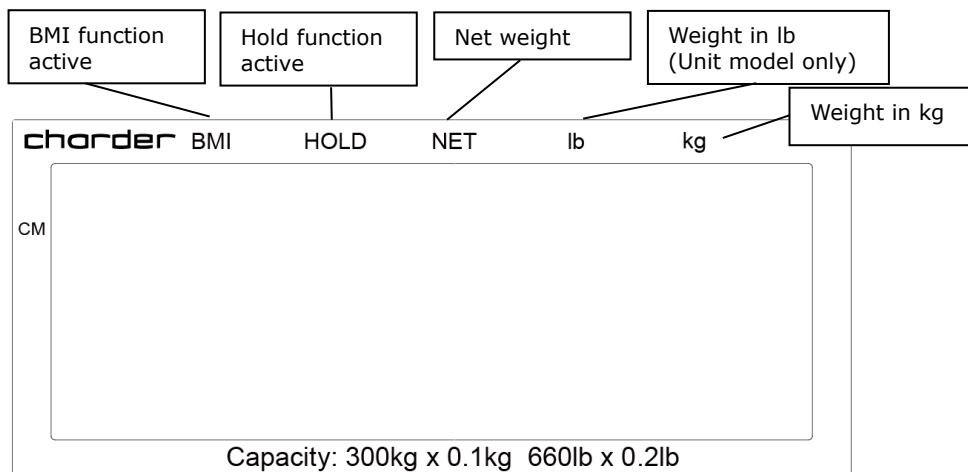

Mostrar


- | | | | |
|--|---------------|---|-----------------------------|
| | Estável | : | Indica que o peso é estável |
| | Peso negativo | : | Peso abaixo de zero |
| | Zero | : | O peso está em zero |

Funções principais

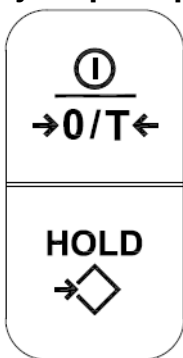


Função de tecla (modelo de 2 teclas)

1.  **→0/T←**: Ligar ou desligar . Redefina o display para 0,0 kg (pode ser usado se estiver dentro de $\pm 2\%$ da capacidade total). Pressione e segure por 3 segundos para desligar.
2. **HOLD** : Determina o valor de pesagem estável - usado quando o peso é instável. Pressione e segure por 3 segundos para entrar nas configurações.

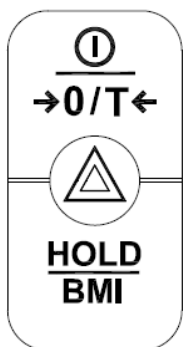

Função de tecla (modelo de 3 teclas)

1.  **→0/T←**: Ligar ou desligar . Redefina o display para 0,0 kg (pode ser usado se estiver dentro de $\pm 2\%$ da capacidade total) . Pressione e segure por 3 segundos para desligar.
2. **HOLD/BMI** : Determina o valor de pesagem estável - usado quando o peso é instável. Pressione e segure por 3 segundos para entrar nas configurações.
3.  **CONFIGURAÇÃO**: Entre nas configurações do dispositivo

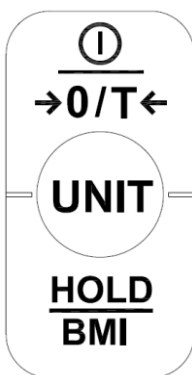

Função da tecla (modelo de unidade de 3 teclas)

1.  **→0/T←**: Ligar ou desligar. Redefina o display para 0,0 kg (pode ser usado se estiver dentro de $\pm 2\%$ da capacidade total) . Pressione e segure por 3 segundos para desligar.
2. **HOLD/BMI** : Determinar valor de pesagem estável - usado quando o peso é instável. Pressione e segure por 3 segundos para entrar no modo BMI.
3. **UNIT** : Alterne entre kg e lb. A última

unidade usada será armazenada na memória. (não funcional no modelo OIML).
Pressione e segure por 3 segundos para entrar nas configurações do dispositivo

VI. Usando o dispositivo

A. Operação básica

Ligue o dispositivo usando  a tecla. O dispositivo executará automaticamente a autocalibração, exibindo a versão do software.

Quando "0,00 kg" aparecer no indicador, o dispositivo estará pronto para medição.

Nota : Se "0,00 kg" não for exibido no indicador, pressione  a tecla para zerar o dispositivo. Esta função pode ser usada para peso dentro de $\pm 2\%$ da capacidade total .

Guie o sujeito para sentar-se sobre a tipoia (ou outro dispositivo conectado ao elevador). Após o peso estabilizar, o símbolo "estável" aparecerá no indicador.

Observação : se o peso do objeto exceder a capacidade da balança (incluindo Tare), o indicador exibirá o aviso "Err" devido à sobrecarga.

B. Hold

A função de retenção determina o peso médio, projetada para ser usada se o peso do sujeito não se estabilizar (por exemplo: uma criança ativa).

Nota: se a flutuação for muito severa, a determinação do peso médio será difícil e a retenção pode não funcionar corretamente.

1. Ligue o dispositivo normalmente.

2. Pressione a tecla  [HOLD] (no modelo de 3 teclas). "HOLD" será exibido no indicador.

3. Realize a medição normalmente.

4. Após alguns segundos, o peso médio será exibido no indicador. Este peso será bloqueado - neste ponto, o movimento do sujeito não afetará o peso.

5. Para liberar o peso bloqueado, pressione a tecla  [HOLD] (no modelo de 3 teclas) novamente para retornar o dispositivo ao

modo normal.

Nota : A função Hold pode ser ativada antes ou depois do assunto fica em pé na plataforma de medição. No entanto, se o sujeito achar difícil ficar parado, recomendamos ativar Hold depois que o sujeito ficar em pé na plataforma.

C. BMI (modelo de 3 chaves)

1. No modo normal, pressione e segure  a tecla para entrar no modo BMI.
2. O display mostrará a última altura registrada. Os dígitos piscarão.
3. Pressione  a tecla para aumentar, [Δ] para diminuir. Pressione e segure para acelerar.
4. Após inserir a altura, pressione  para confirmar.
5. prossiga para pesar o sujeito como de costume. O indicador exibirá peso, altura e BMI.

NOTA : A função Hold pode ser usada neste momento se o peso estiver instável

6. Pressione  a tecla para retornar ao modo normal.

Categoria	BMI(kg/m ²)	Risco de doenças relacionadas à obesidade
Sob	< 18,5	Baixo
Normal	18,5-24,9	Média
Sobre	24,9-29,9	Ligeiramente aumentado
Obeso I	30,0-34,9	Aumentou
Obeso II	35,0-39,9	Alto
Obeso III	> 40	Muito alto

(Padrões de BMI para adultos da Organização Mundial da Saúde)

OBSERVAÇÃO : embora o BMI seja calculado da mesma maneira, indivíduos com menos de 18 anos devem usar padrões separados para interpretação, em comparação com gráficos de percentis para sua faixa etária.

D. Tare

A função de Tare permite ao usuário deduzir o peso dos objetos do resultado da medição do dispositivo.

1. Coloque o objeto que precisa ser Tareado na tipoia.

2. Pressione  a tecla após o símbolo estável aparecer no indicador. O display indicará "0,00 kg".
3. Guie o sujeito (mais o objeto Taredo) a ser pesado na funda. Conduza a medição.
4. Para limpar o valor da Tare, remova todos os objetos da plataforma de medição e pressione  a tecla

VII. Configuração do dispositivo

Modelo de 2 teclas

Quando o dispositivo estiver ligado, pressione e segure a tecla **[HOLD]** por cerca de 3 segundos , até que o visor mostre " SETUP " , seguido de " A _ OFF " (primeira opção no menu de configuração) .

No menu de configuração do dispositivo:

[HOLD] para alternar a próxima opção do menu



para confirmar a seleção / entrar no submenu

Desligamento automático :

Instrua o dispositivo a desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

Opções de desligamento automático: 120 seg / 180 seg / 240 seg / 300 seg / desligado

Pressione **[HOLD]** para alternar entre as opções de tempo e



para confirmar a seleção.

Campainha/Bipe :



Quando a função estiver ativada, um sinal sonoro será emitido quando: o indicador estiver ligado, as teclas forem pressionadas e o peso estiver estável.

Pressione **[HOLD]** para alternar entre ligado/desligado e



tecla para confirmar a seleção.

Modelo △ de 3 teclas

Quando o dispositivo estiver ligado, pressione e segure a tecla △ por cerca de 3 segundos , até que o visor mostre " SETUP " , seguido de " A _ OFF " (primeira opção no menu de configuração) .

No menu de configuração do dispositivo:



para alternar a próxima opção do menu



para confirmar a seleção / entrar no submenu

Desligamento automático :

Instrua o dispositivo a desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

Opções de desligamento automático: 120 seg / 180 seg / 240 seg / 300 seg / desligado

Pressione  para alternar entre as opções de tempo e  para confirmar a seleção.

Campainha/Bipe :

Quando a função estiver ativada, um sinal sonoro será emitido quando: o indicador estiver ligado, as teclas forem pressionadas e o peso estiver estável.

Pressione  para alternar entre ligado/desligado e  a tecla para confirmar a seleção.

Modelo de unidade de 3 chaves

Com o aparelho ligado, pressione e segure a  tecla por cerca de 3 segundos , até que o display mostre “ SETUP” seguido de “ A_OFF ” (primeira opção do menu de configuração) .

No menu de configuração do dispositivo:

- 1、  para alternar a próxima opção do menu
- 2、  para confirmar a seleção / entrar no submenu

Desligamento automático :

Instrua o dispositivo a desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

Opções de desligamento automático: 60 seg / 120 seg / 180 seg / 240 seg / 300 seg / desligado

Pressione  para alternar entre as opções de tempo e  para confirmar a seleção.

Campainha/Bipe :

Quando a função estiver ativada, um sinal sonoro será emitido quando: o indicador estiver ligado, as teclas forem pressionadas e o peso estiver estável.

Pressione  para alternar entre ligado/desligado e  a tecla para confirmar a seleção.

VIII. Solução de problemas

Defeitos do produto

da Charder é válida para o comprador original deste dispositivo, sujeita aos termos e condições listados no Programa de Garantia e Política de Devolução.

1. Se a Charder for responsável por uma falha ou defeito presente no recebimento da unidade, a Charder deverá reparar a falha ou fornecer uma unidade de substituição. Caso os reparos ou a entrega da substituição falhem, as disposições legais serão válidas. O período de garantia será de dois anos, a partir da data da compra. Guarde seu recibo como prova de compra.

2. Nenhuma responsabilidade será aceita por danos causados por qualquer um dos seguintes motivos: armazenamento ou uso inadequado ou impróprio, instalação ou comissionamento incorreto pelo proprietário ou terceiros, desgaste natural, alterações ou modificações, manuseio incorreto ou negligente, interferência química, eletroquímica ou elétrica, a menos que o dano seja atribuível à negligência da Charder .

Se o dispositivo não estiver coberto pela garantia, será cobrada uma taxa de manutenção e serviço, além do custo das peças de reposição.

Antes de entrar em contato com seu distribuidor local da Charder para serviço de reparo, recomendamos considerar os seguintes procedimentos de solução de problemas :

Auto-inspeção

1. O dispositivo não liga

- Se a bateria estiver descarregada, substitua-a por novas

2. Indicador mostrando "0 0 000" ZERO SPAN fora do intervalo

- Interferência devido a fatores como perturbação de RF ou vibração do solo. Reposicione o dispositivo para o local sem interferência e tente novamente
- Objetos externos interferindo com o dispositivo. Limpe a área de objetos interferentes e tente novamente
- Se as etapas acima não resolverem o problema, pode ser necessária uma recalibração para corrigir a precisão da pesagem.

É necessário suporte do distribuidor

Se ocorrerem os seguintes erros, recomendamos entrar em contato com seu distribuidor local da Charder para serviços de reparo ou substituição:

1. O dispositivo não liga

- Tecla liga/desliga com defeito
- Fios quebrados ou danificados causando curto-circuito ou conexão defeituosa
- Queima do fusível de segurança

2. Indicador de dano

- Possíveis defeitos de hardware incluem: brilho irregular na tela LCD, texto borrado, tela de arco-íris manchada, exibição decimal incorreta
- Não é possível salvar ou ler dados
- O indicador mostra "ERRL" após o dispositivo ser ligado
- As teclas não respondem
- Mau funcionamento do buzzer

É necessário suporte do distribuidor

Se ocorrerem os seguintes erros, recomendamos entrar em contato com seu distribuidor local da Charder para serviços de reparo ou substituição:



1. O dispositivo não liga

- Tecla liga/desliga com defeito
- Fios quebrados ou danificados causando curto-circuito ou conexão defeituosa
- Queima do fusível de segurança
- Adaptador com defeito

2. Indicador de dano

- Possíveis defeitos de hardware incluem: brilho irregular na tela LCD, texto borrado, tela de arco-íris manchada, exibição decimal incorreta
- Não é possível salvar ou ler dados
- O indicador mostra "ERRL" após o dispositivo ser ligado
- As teclas não respondem
- Mau funcionamento do buzzer

Mensagens de erro

Mensagem de erro	Razão	Ação
	Aviso de bateria fraca A voltagem da bateria está muito baixa para operar o dispositivo	Substituir pilhas
	Sobrecarga A carga total excede a capacidade máxima do dispositivo	Reduza o peso na plataforma de medição e tente novamente
	Erro de contagem Sinal das células de carga muito baixo	Erro normalmente causado por célula de carga ou fiação defeituosa. Entre em contato com o distribuidor
	Contagem zero sobre a faixa de calibração zero +10% enquanto estiver ligado	Recalibração necessária. Entre em contato com o distribuidor
	Contagem zero sob calibração intervalo zero -10% enquanto ligado	Recalibração necessária. Entre em contato com o distribuidor
	Erro de programa Falha no software do dispositivo	Entre em contato com o distribuidor

IX. Especificações do produto

A. Informações do dispositivo

Modelo		MHS25 00 Eu	
Medição de peso	Capacidade	300kg x 0.1 kg	400 kg x 0.2 kg
	Precisão	$\pm 1.5e$	
	OIML	Classe III	
	Tela LCD	Tela LCD de 1,0 polegadas (5 1/2 dígitos)	
Dimensões	Geral	122(W) x 52(D) x 180(H) mm	
	Peso do dispositivo	1.04 kg	
Funções principais (modelo de 2 teclas)		On/Off/Zero/Tare, Hold	
Funções principais (modelo de 3 teclas)		On/Off/Zero/Tare, Hold/BMI Unit (non-OIML model) △Setup (OIML model)	
Fonte de energia		6 pilhas AAA	
Ambiente de operação		0°C~+40°C 15% / 85% RH 700 hPa ~1060 hPa	

Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

X. Declaração de Conformidade

Este produto foi fabricado de acordo com as normas europeias harmonizadas, seguindo as disposições das diretrizes abaixo mencionadas:

	Regulamento (UE) 2017/745 sobre Dispositivos Médicos
	Diretiva 2014/31/UE para nstrumentos de Pesagem Não Automáticos (apenas para modelos OIML)

RoHS Directive 2011/65/EU and Delegated Directive (EU) 2015/863

Radio Equipment Directive 2014/53/EU
(aplicável se o módulo sem fio for utilizado)

Part 15 of the Federal Communications Statement Rules

Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais.
Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam causar um funcionamento indesejado.

Consulte o documento separado que mostra as marcações no adesivo do dispositivo.

Representante Autorizado na UE:



Obelis s.a.

Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels
Belgium



Fabricado por:
Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

CD-IN-01035 REV001 01/2025